



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D221179 S

(45)公告日：中華民國 111 (2022) 年 09 月 21 日

(21)申請案號：110303802

(22)申請日：中華民國 110 (2021) 年 07 月 21 日

(51)LOC.(13)Cl.：14-04

(71)申請人：智慧生醫電子股份有限公司(中華民國) (TW)

桃園市平鎮區復旦里文化街 236 巷 20 號(1 樓)

(72)設計人：何彥毅(TW)；龔輝雲(TW)；黃柏豪(TW)；黃彥允(TW)

(74)代理人：王清煌

(56)參考文獻：

US D914712

US D919642

US D923041

US D925570

審查人員：劉信邦

圖式數：60 共 32 頁


(54)名稱

電腦程式產品之操作選單

代表圖：

<table border="1"> <tr> <td>Name Peter Wu</td> <td>ID Number A123456789</td> </tr> <tr> <td>Passport No. 123456789</td> <td>Nationality USA </td> </tr> <tr> <td>Sex 123456789</td> <td>Date of Issue 2020/12/25</td> </tr> <tr> <td>Date of Birth 1998/12/25</td> <td>Date of Expiry 2030/12/25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Authority UNITED STATE OF AMERICA</td> </tr> </table>		Name Peter Wu	ID Number A123456789	Passport No. 123456789	Nationality USA	Sex 123456789	Date of Issue 2020/12/25	Date of Birth 1998/12/25	Date of Expiry 2030/12/25	Authority UNITED STATE OF AMERICA											
Name Peter Wu	ID Number A123456789																				
Passport No. 123456789	Nationality USA																				
Sex 123456789	Date of Issue 2020/12/25																				
Date of Birth 1998/12/25	Date of Expiry 2030/12/25																				
Authority UNITED STATE OF AMERICA																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vaccine COVID-19</th> </tr> <tr> <th>Dose</th> <th>Mfr. Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> AZ</td> <td>21/06/30</td> </tr> <tr> <td> UBI</td> <td>22/09/27</td> </tr> <tr> <td> BNT</td> <td>23/10/01</td> </tr> </tbody> </table>	Vaccine COVID-19		Dose	Mfr. Date	AZ	21/06/30	UBI	22/09/27	BNT	23/10/01	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Testing COVID-19</th> </tr> <tr> <th>Type</th> <th>Result Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> -</td> <td>21/04/30</td> </tr> <tr> <td> -</td> <td>21/05/20</td> </tr> <tr> <td> ⇨</td> <td>21/09/30</td> </tr> </tbody> </table>	Testing COVID-19		Type	Result Date	-	21/04/30	-	21/05/20	⇨	21/09/30
Vaccine COVID-19																					
Dose	Mfr. Date																				
AZ	21/06/30																				
UBI	22/09/27																				
BNT	23/10/01																				
Testing COVID-19																					
Type	Result Date																				
-	21/04/30																				
-	21/05/20																				
⇨	21/09/30																				
Image	Image																				

前視圖 1

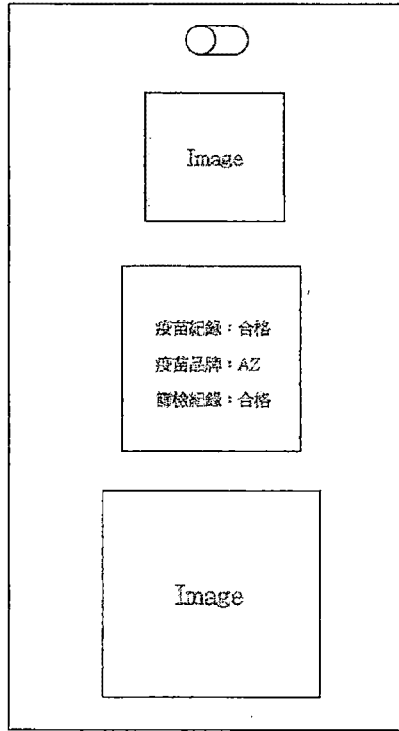

變化狀態圖 1

D221179

設計專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

【設計名稱】(中文/英文)

電腦程式產品之操作選單

【物品用途】

【0001】 (略)

【設計說明】

【0002】 圖式所揭露之各視圖，為多個不同變化外觀之圖像設計。圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分。

【0003】 可由前視圖產生變化狀態圖1、變化狀態圖2-1、變化狀態圖3-1、變化狀態圖4-1、變化狀態圖5-1。

【0004】 可由變化狀態圖2-1產生變化狀態圖2-2、變化狀態圖2-3、變化狀態圖2-4、變化狀態圖2-5、變化狀態圖2-6。

【0005】 可由變化狀態圖3-1產生變化狀態圖3-2、變化狀態圖3-3、變化狀態圖3-4、變化狀態圖3-5、變化狀態圖3-6。可由變化狀態圖3-1、變化狀態圖3-2、變化狀態圖3-3、變化狀態圖3-4、變化狀態圖3-5、變化狀態圖3-6的任一個產生變化狀態圖3-1-1。

【0006】 可由變化狀態圖4-1產生變化狀態圖4-2、變化狀態圖4-3、變化狀態圖4-4、變化狀態圖4-5、變化狀態圖4-6。可由變化狀態圖4-1、變化狀態圖4-2、變化狀態圖4-3、變化狀態圖4-4、變化狀態圖4-5、變化狀態圖4-6的任一個產生變化狀態圖4-1-1。


【0007】 可由變化狀態圖5-1產生變化狀態圖5-2、變化狀態圖5-3、變化狀態圖5-4、變化狀態圖5-5、變化狀態圖5-6。可由變化狀態圖5-1、變化

狀態圖5-2、變化狀態圖5-3、變化狀態圖5-4、變化狀態圖5-5、變化狀態圖5-6的任一個產生變化狀態圖5-1-1、變化狀態圖5-1-2。


【0008】 使用狀態參考圖1至30係表示本設計應用於手機之實施態樣。

圖式

(指定之代表圖，請單獨置於圖式第1頁)

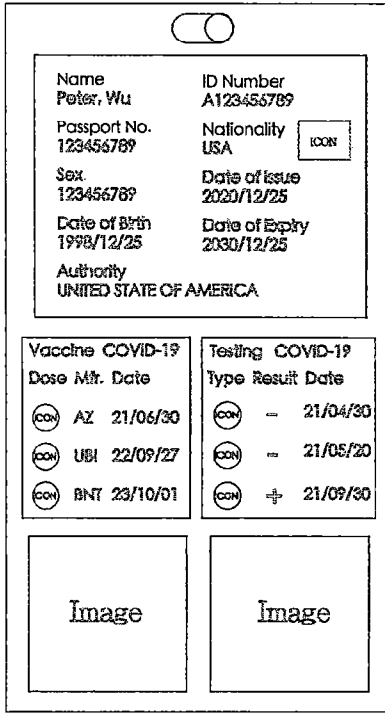

前視圖 1

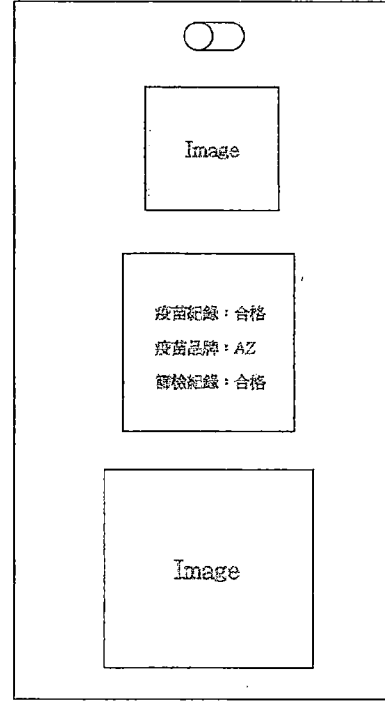

變化狀態圖 1

接種資訊 - AZ	
接種日期	疫苗序號
2021/08/30	123456789
接種地點	疫苗批號
台灣, 台北市	123456789
接種單位	製造日期
台北榮民總醫院	2021/01/01
注射醫師	有效日期
王小明	2021/08/30
注射護士	製造廠商
王小美	AstraZeneca
注意事項 兩劑施打時間需間隔至少8週,	
●●●●●●	
返回	

變化狀態圖 2-1

接種資訊 - AZ	
接種日期	疫苗序號
2021/08/30	123456789
接種地點	疫苗批號
台灣, 台北市	123456789
接種單位	製造日期
台北榮民總醫院	2021/01/01
注射醫師	有效日期
王小明	2021/08/30
注射護士	製造廠商
王小美	AstraZeneca
注意事項 兩劑施打時間需間隔至少8週,	
●●●●●●	
返回	

變化狀態圖 2-2

接種資訊 - AZ

接種日期	疫苗序號
2021/08/30	123456789
接種地點	疫苗批號
台灣, 台北市	123456789
接種單位	製造日期
台北榮民總醫院	2021/01/01
注射醫師	有效日期
王小明	2021/08/30
注射護士	製造廠商
王小美	AstraZeneca
注意事項 兩劑施打時間需間隔至少8週, ...	

●●●●●●

(返回)

變化狀態圖 2-3

接種資訊 - AZ

接種日期	疫苗序號
2021/08/30	123456789
接種地點	疫苗批號
台灣, 台北市	123456789
接種單位	製造日期
台北榮民總醫院	2021/01/01
注射醫師	有效日期
王小明	2021/08/30
注射護士	製造廠商
王小美	AstraZeneca
注意事項 兩劑施打時間需間隔至少8週, ...	

●●●●●●

(返回)

變化狀態圖 2-4

接種資訊 - AZ

接種日期	疫苗序號
2021/08/30	123456789
接種地點	疫苗批號
台灣, 台北市	123456789
接種單位	製造日期
台北榮民總醫院	2021/01/01
注射醫師	有效日期
王小明	2021/08/30
注射護士	製造廠商
王小美	AstraZeneca
注意事項	
兩劑施打時間需間隔至少8週,	

●●●●○

[返回](#)

變化狀態圖 2-5

接種資訊 - AZ

接種日期	疫苗序號
2021/08/30	123456789
接種地點	疫苗批號
台灣, 台北市	123456789
接種單位	製造日期
台北榮民總醫院	2021/01/01
注射醫師	有效日期
王小明	2021/08/30
注射護士	製造廠商
王小美	AstraZeneca
注意事項	
兩劑施打時間需間隔至少8週,	

●●●●○

[返回](#)

變化狀態圖 2-6



變化狀態圖 3-1



變化狀態圖 3-2

抗體檢測 - ABT
Antibody Test

IgG: - 篩檢日期: 2021/07/10
儀器廠牌: Merck
篩檢地點: 台灣, 台北市
IgM: + 篩檢單位: 台北榮民總醫院

IgG: - 篩檢日期: 2021/06/14
儀器廠牌: Merck
篩檢地點: 台灣, 台北市
IgM: - 篩檢單位: 台北榮民總醫院

IgG: - 篩檢日期: 2021/05/30
儀器廠牌: Merck
篩檢地點: 台灣, 台北市
IgM: - 篩檢單位: 台北榮民總醫院

●●●●●●

圖表
返回

變化狀態圖 3-3

抗體檢測 - ABT
Antibody Test

IgG: - 篩檢日期: 2021/07/10
儀器廠牌: Merck
篩檢地點: 台灣, 台北市
IgM: + 篩檢單位: 台北榮民總醫院

IgG: - 篩檢日期: 2021/06/14
儀器廠牌: Merck
篩檢地點: 台灣, 台北市
IgM: - 篩檢單位: 台北榮民總醫院

IgG: - 篩檢日期: 2021/05/30
儀器廠牌: Merck
篩檢地點: 台灣, 台北市
IgM: - 篩檢單位: 台北榮民總醫院


●●●●●●

圖表
返回

變化狀態圖 3-4



變化狀態圖 3-5

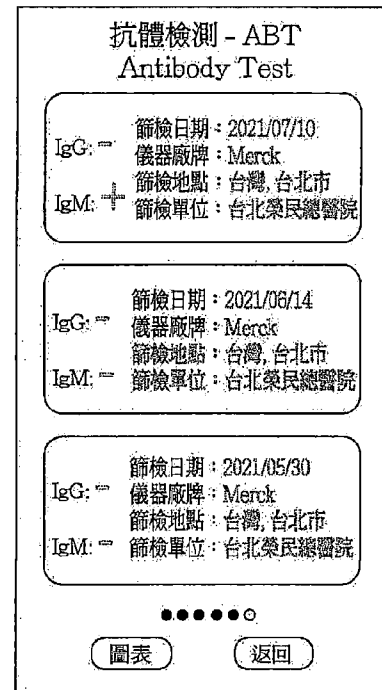

變化狀態圖 3-6



變化狀態圖 4-1



變化狀態圖 4-2

核酸檢測 - PCR
Polymerase Chain Reaction

篩檢日期: 2021/07/10
 CT值: 35
 Neg
 試劑廠牌: Abbott
 篩檢地點: 台灣, 台北市
 篩檢單位: 台北榮民總醫院

篩檢日期: 2021/06/14
 CT值: 28
 Pos
 試劑廠牌: Abbott
 篩檢地點: 台灣, 台北市
 篩檢單位: 台北榮民總醫院

篩檢日期: 2021/05/30
 CT值: 10
 Pos
 試劑廠牌: Abbott
 篩檢地點: 台灣, 台北市
 篩檢單位: 台北榮民總醫院

●●●●●●

變化狀態圖 4-3

核酸檢測 - PCR
Polymerase Chain Reaction


篩檢日期: 2021/07/10
 CT值: 35
 Neg
 試劑廠牌: Abbott
 篩檢地點: 台灣, 台北市
 篩檢單位: 台北榮民總醫院

篩檢日期: 2021/06/14
 CT值: 28
 Pos
 試劑廠牌: Abbott
 篩檢地點: 台灣, 台北市
 篩檢單位: 台北榮民總醫院


篩檢日期: 2021/05/30
 CT值: 10
 Pos
 試劑廠牌: Abbott
 篩檢地點: 台灣, 台北市
 篩檢單位: 台北榮民總醫院

●●●●●●

變化狀態圖 4-4

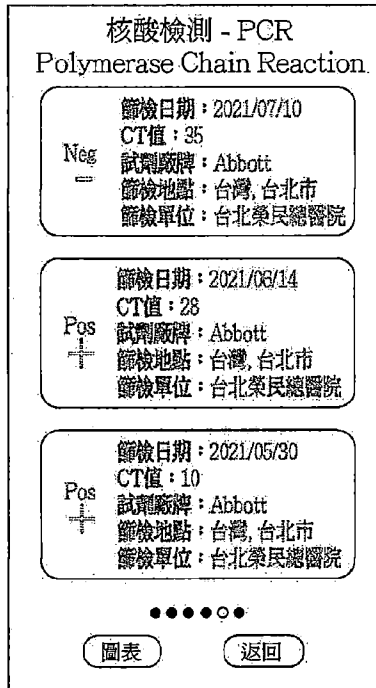

變化狀態圖 4-5

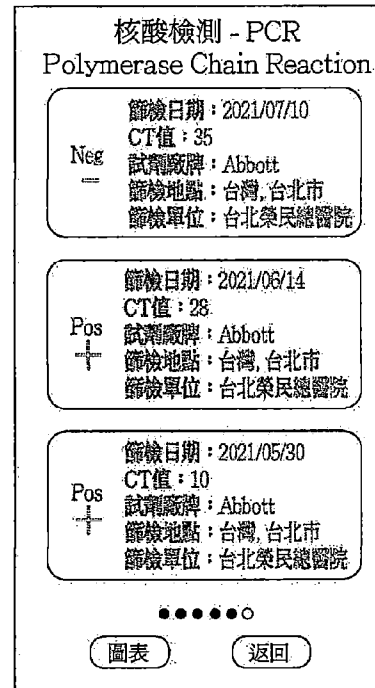

變化狀態圖 4-6



變化狀態圖 5-1



變化狀態圖 5-2



變化狀態圖 5-3




變化狀態圖 5-4




變化狀態圖 5-5




變化狀態圖 5-6

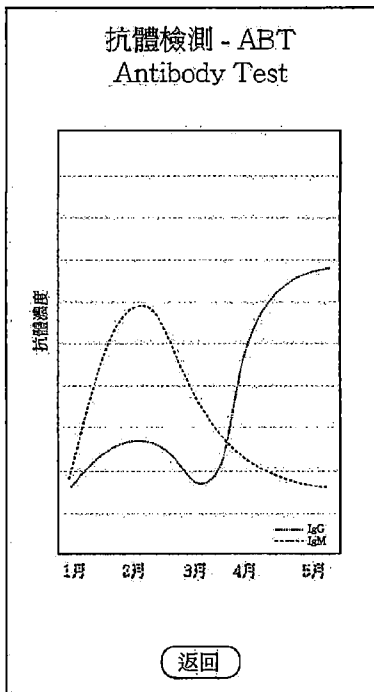


變化狀態圖 3-1-1

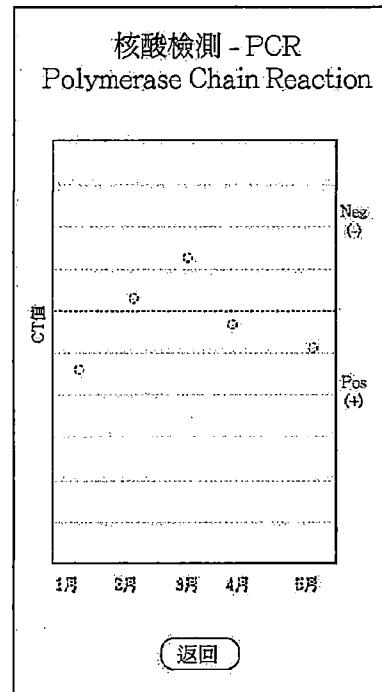


變化狀態圖 4-1-1

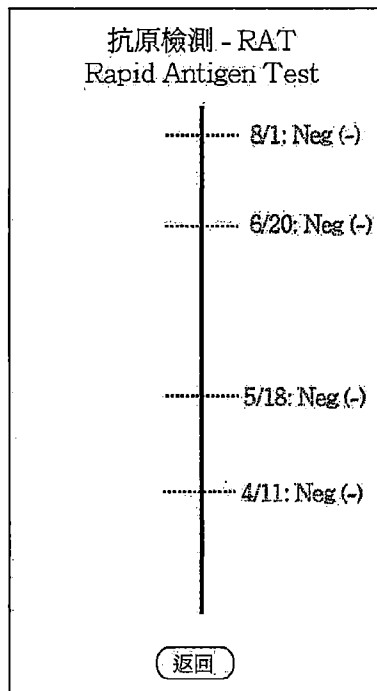


變化狀態圖 5-1-1

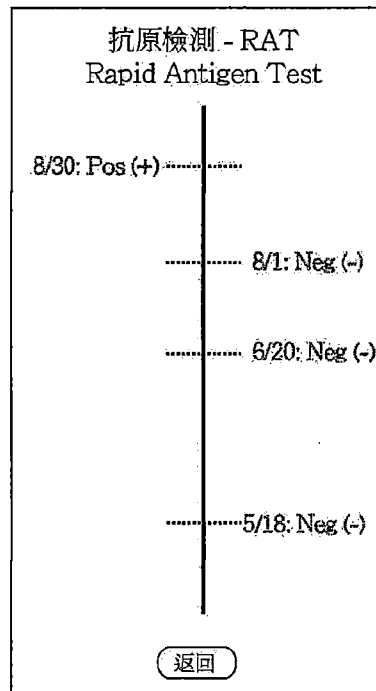


變化狀態圖 5-1-2

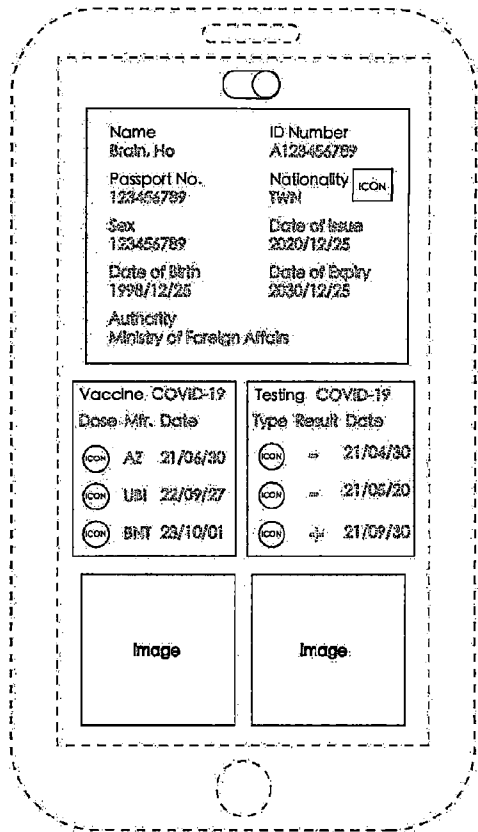


使用狀態參考圖 1

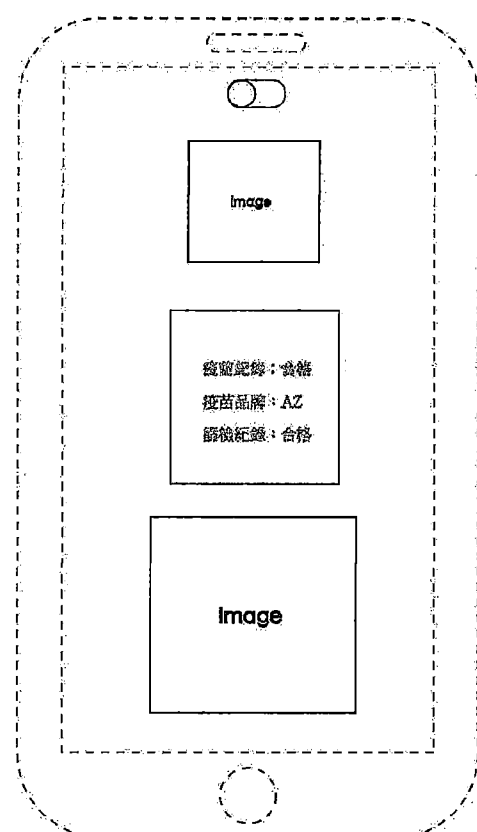

使用狀態參考圖 2

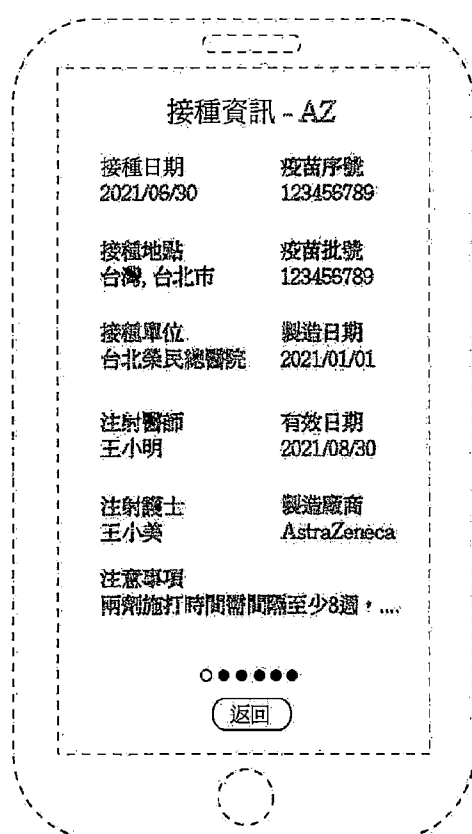


使用狀態參考圖 3

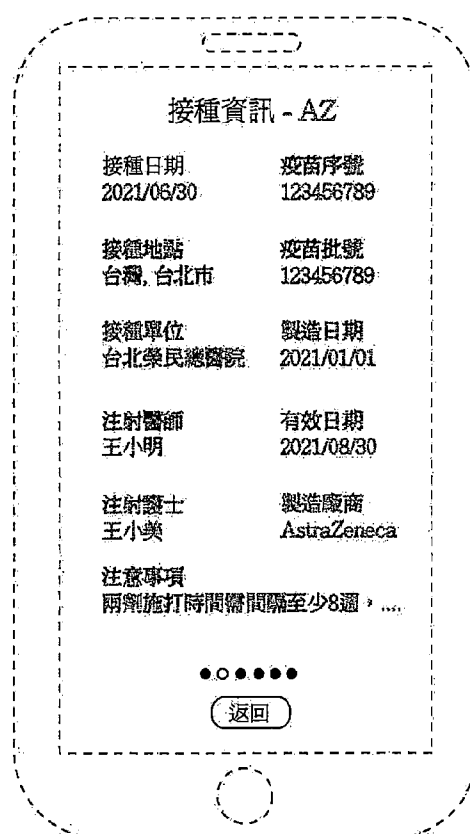


使用狀態參考圖 4




使用狀態參考圖 5

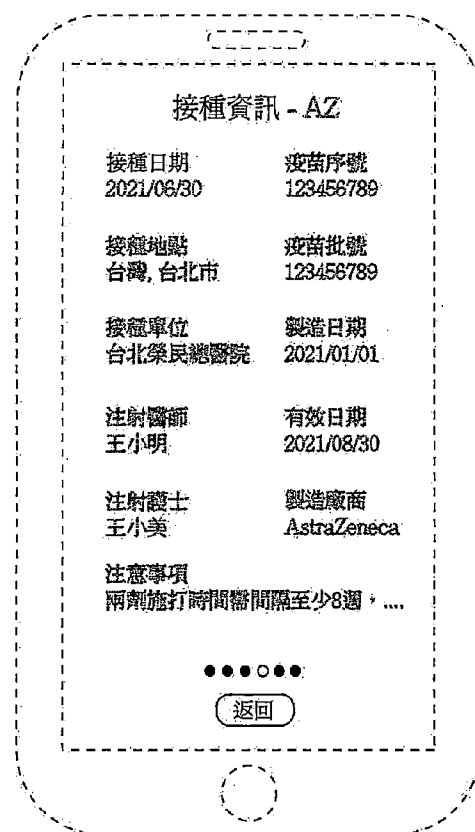

使用狀態參考圖 6

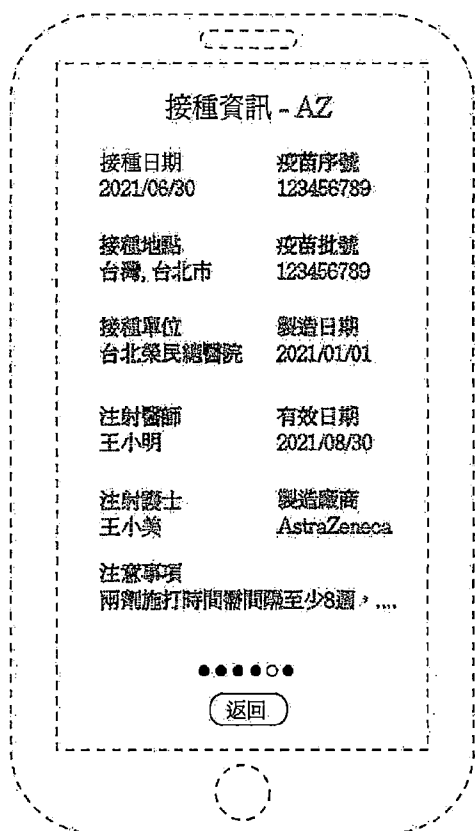


使用狀態參考圖 7

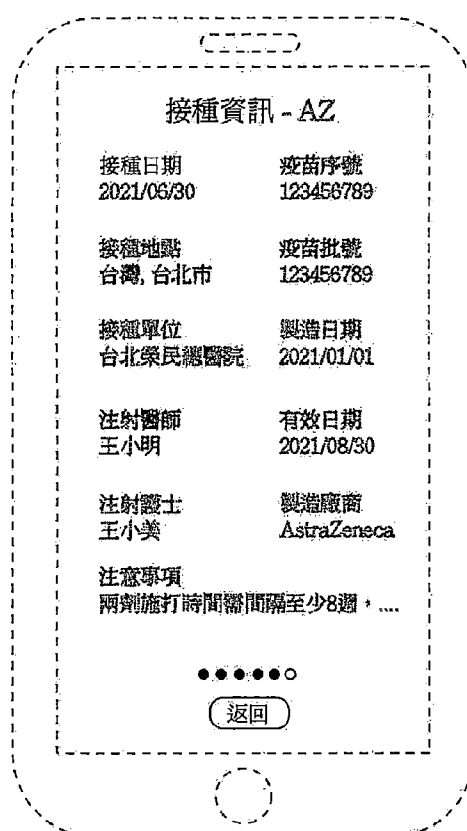


使用狀態參考圖 8


0000

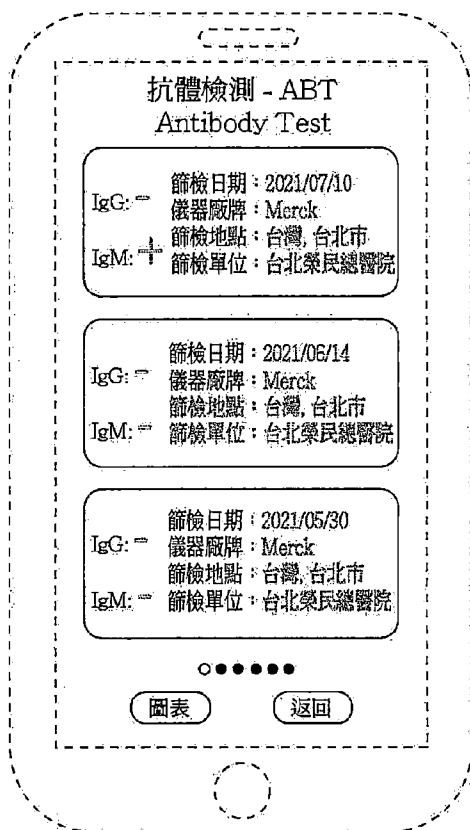


使用狀態參考圖 9

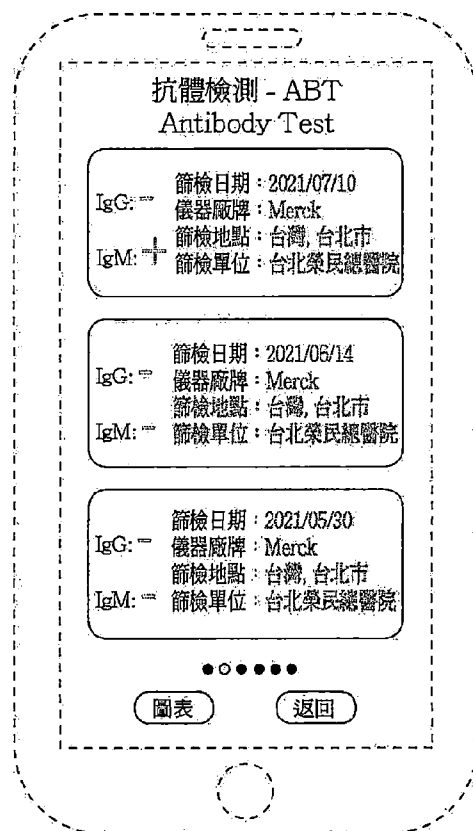


使用狀態參考圖 10

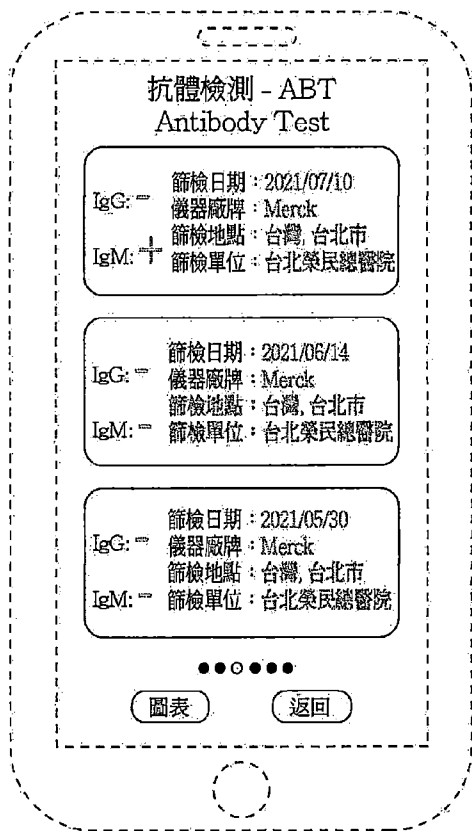


使用狀態參考圖 11

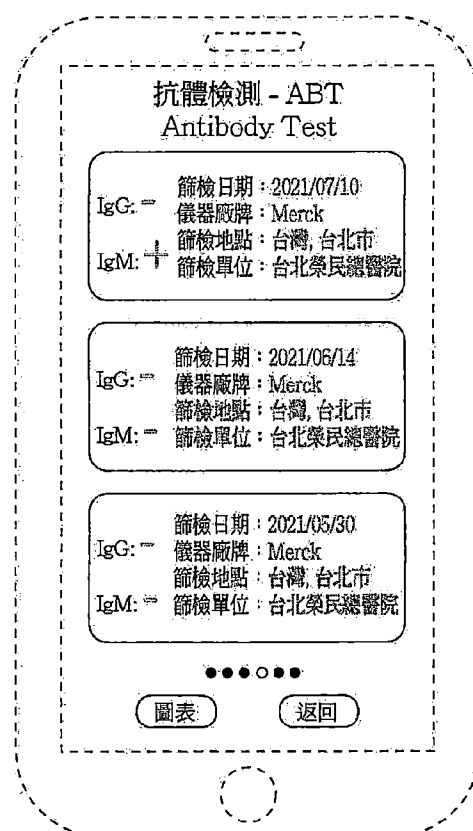


使用狀態參考圖 12

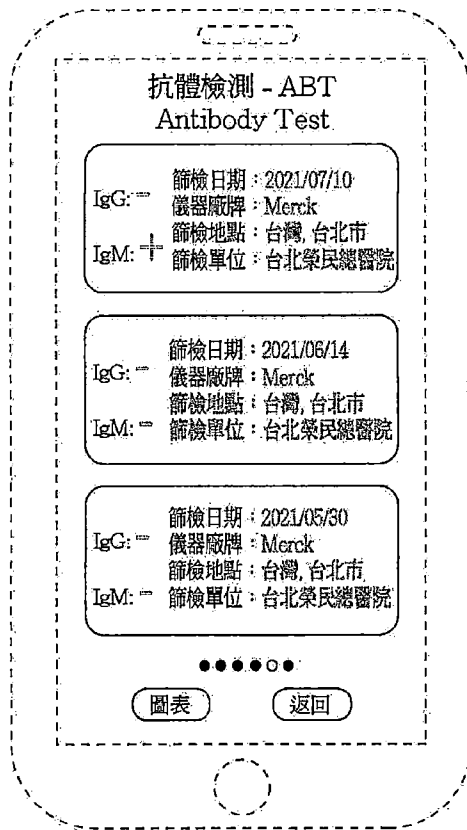


使用狀態參考圖 13

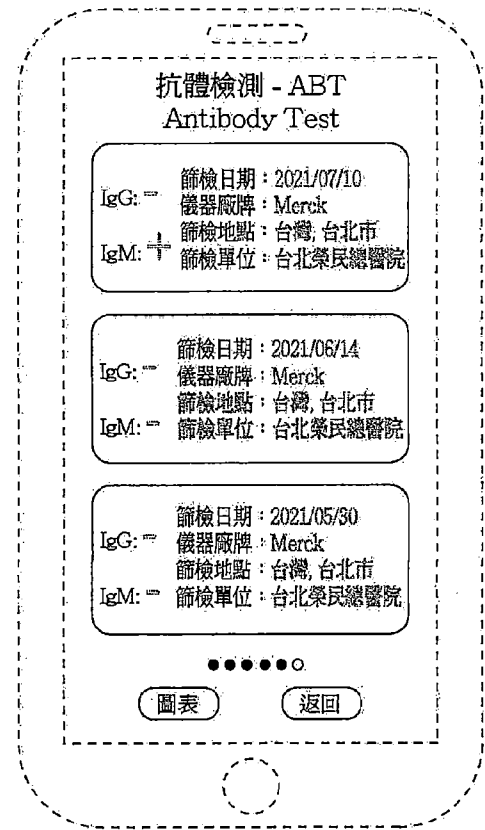


使用狀態參考圖 14

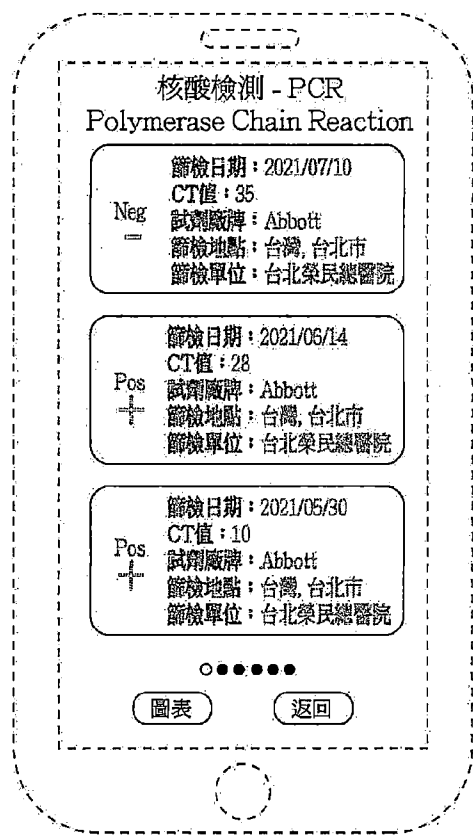


使用狀態參考圖 15

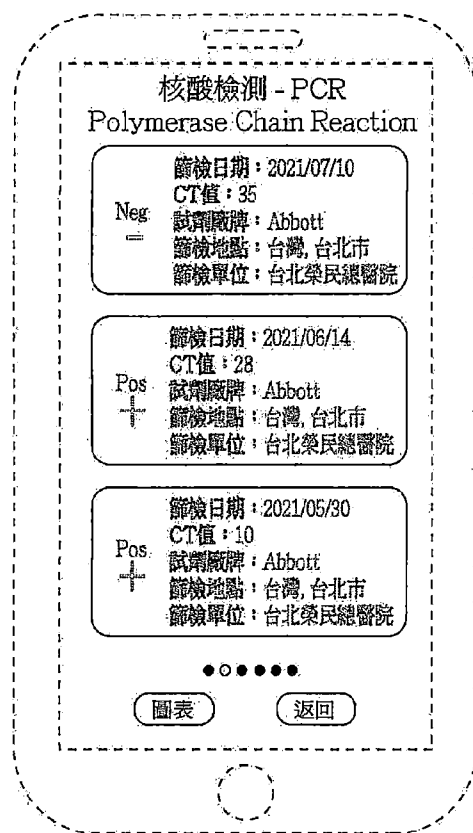


使用狀態參考圖 16

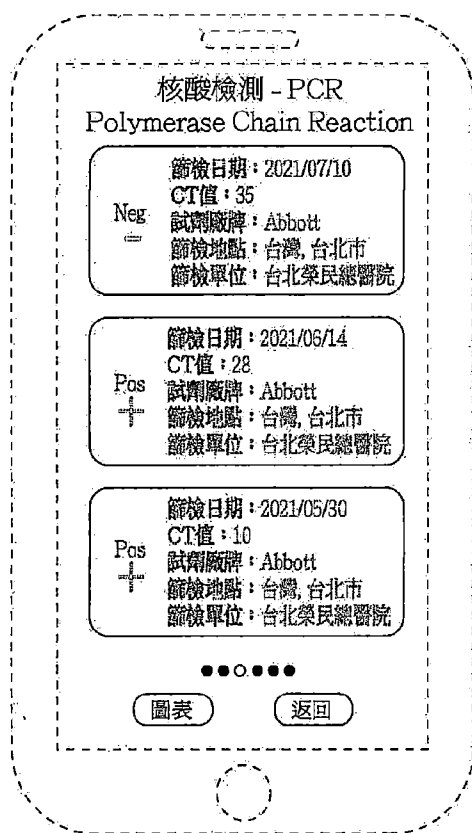


使用狀態參考圖 17

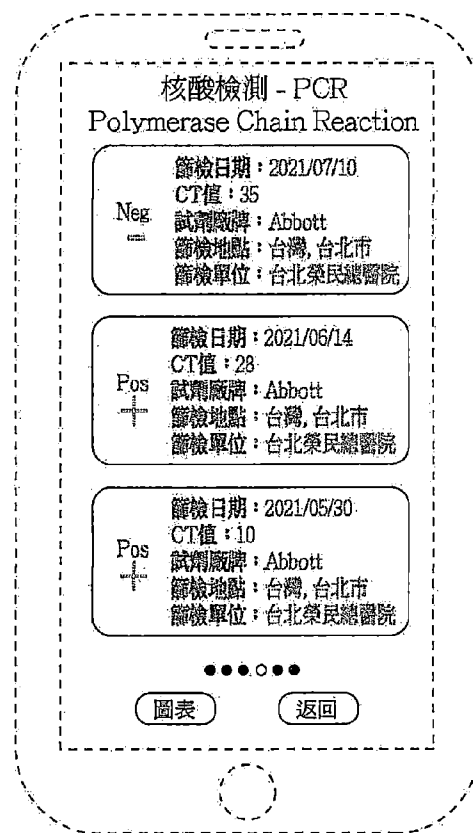


使用狀態參考圖 18

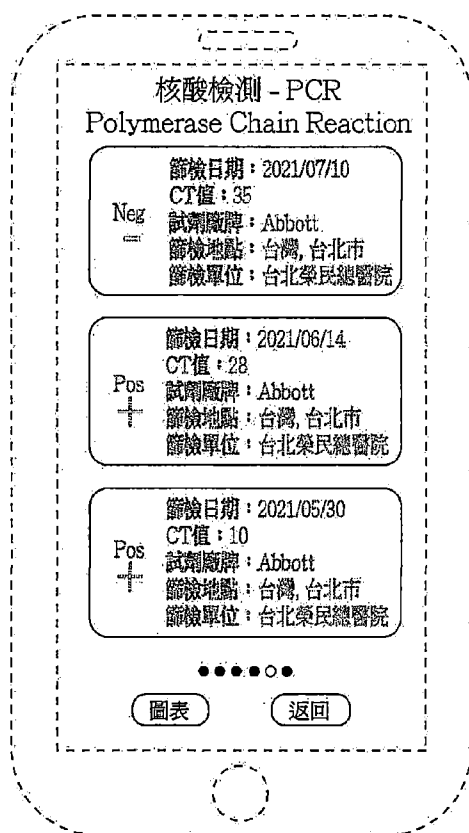


使用狀態參考圖 19

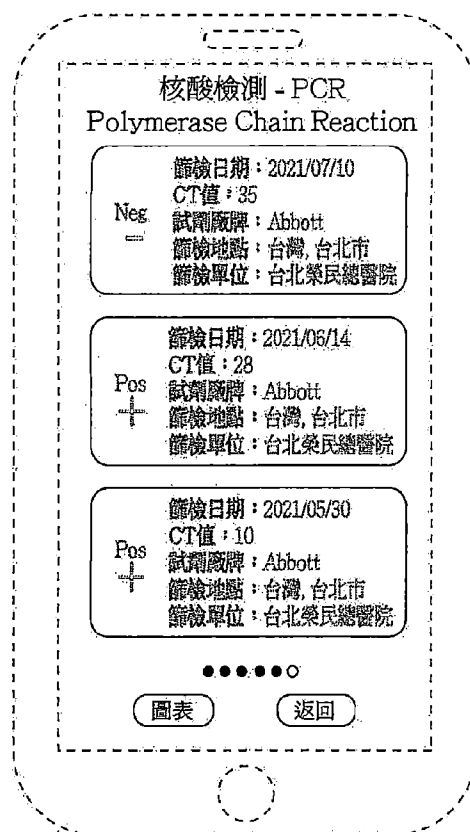


使用狀態參考圖 20

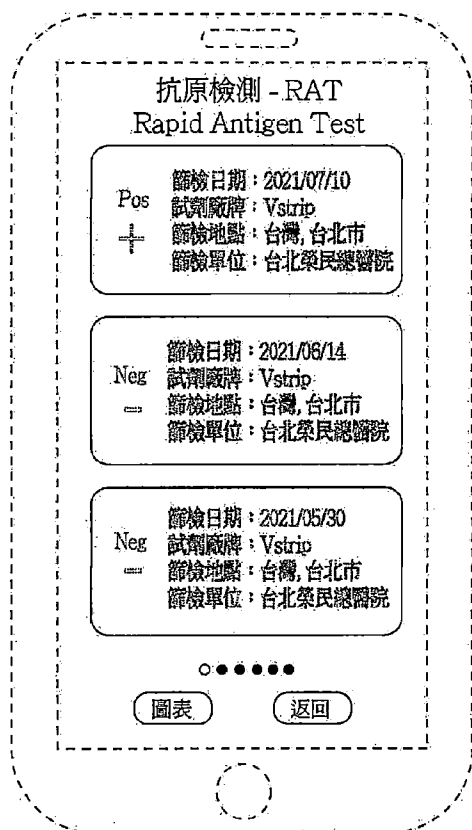


使用狀態參考圖 21

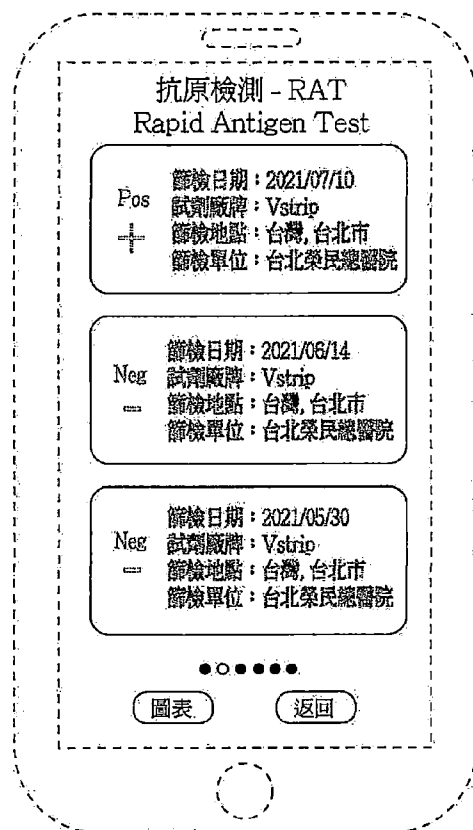


使用狀態參考圖 22

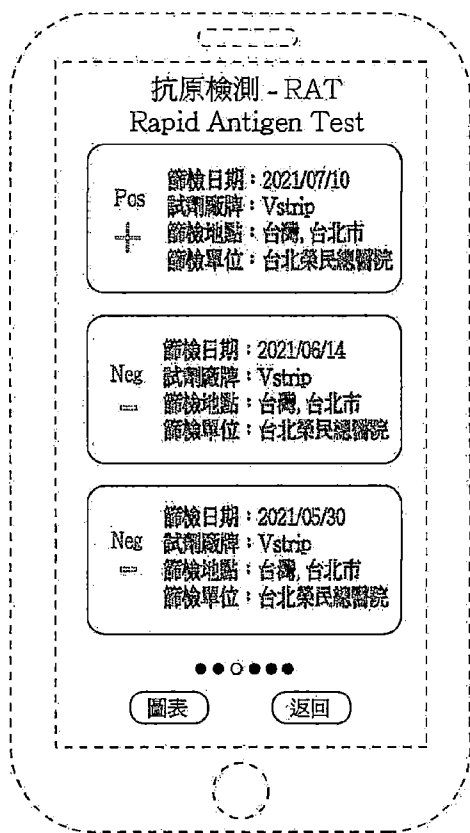


使用狀態參考圖 23

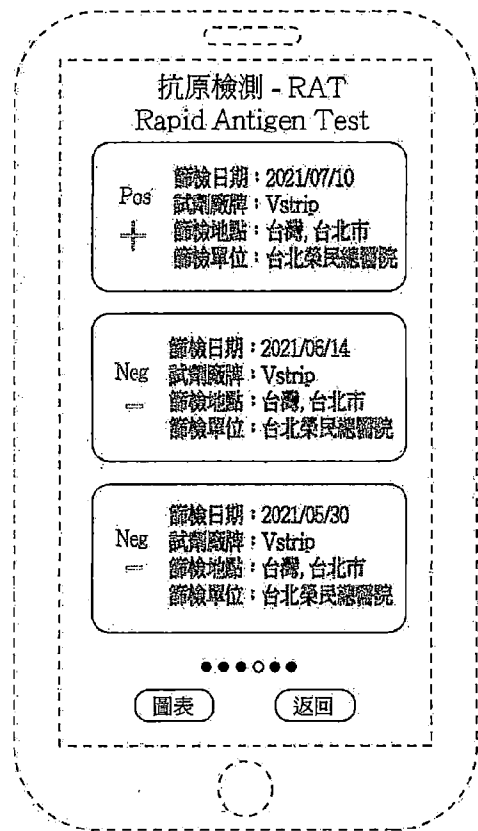


使用狀態參考圖 24

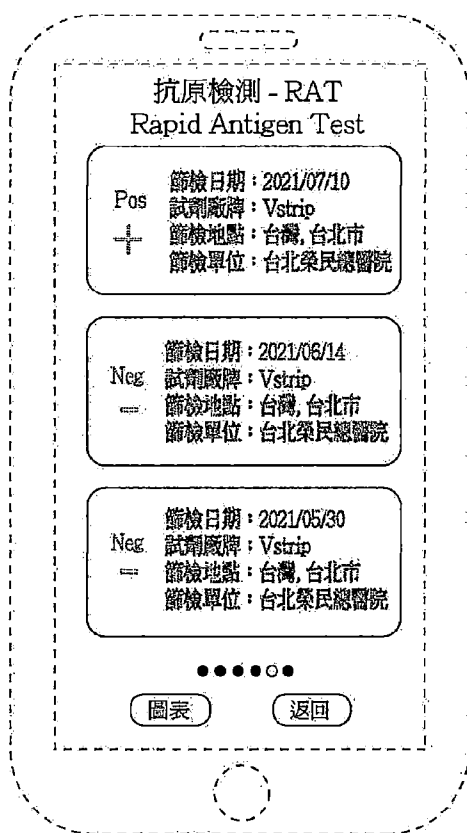


使用狀態參考圖 25

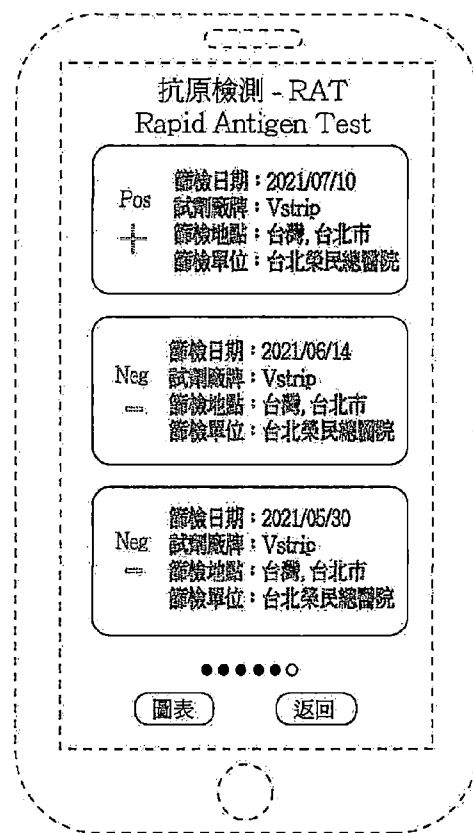


使用狀態參考圖 26

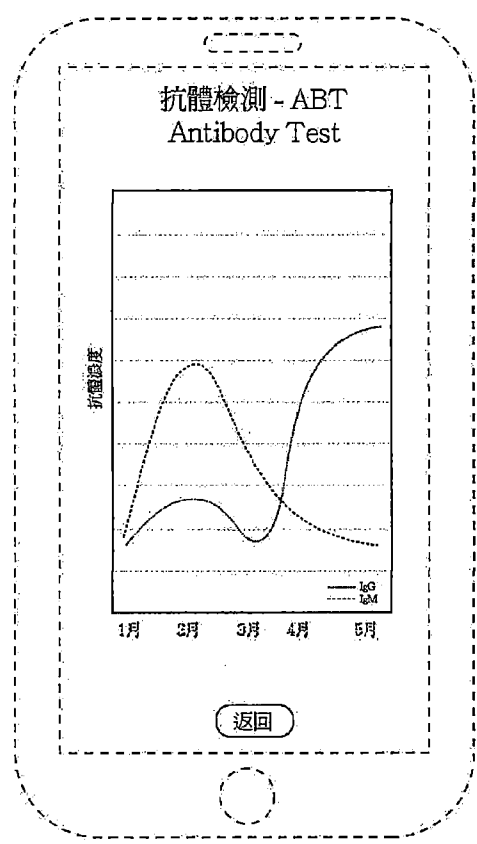


使用狀態參考圖 27

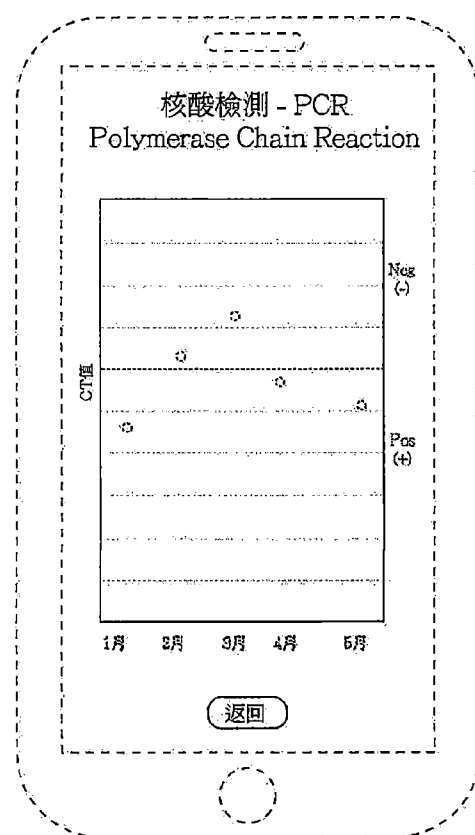

使用狀態參考圖 28

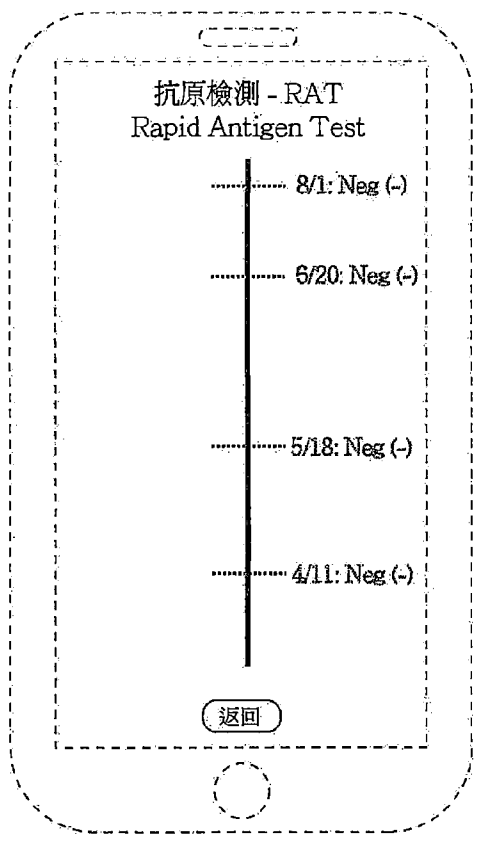

使用狀態參考圖 29

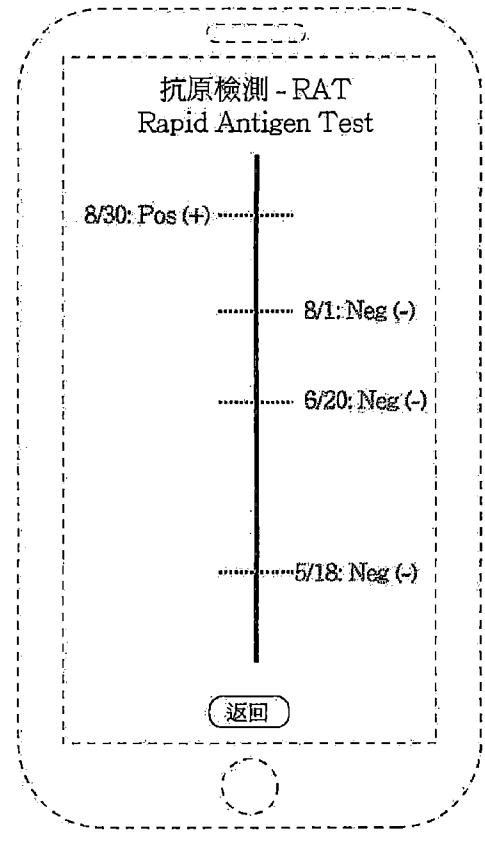

使用狀態參考圖 30